


Motori da endodonzia e da implantologia

Sondaggio su **230** responder


1 Quale è il criterio fondamentale di scelta di un eventuale motore da Implantologia?

Reputazione della Marca	31	13%
Facilità e semplicità di utilizzo	50	22%
Affidabilità del prodotto	103	45%
Torque di inserzione	23	10%
Prezzo	23	10%

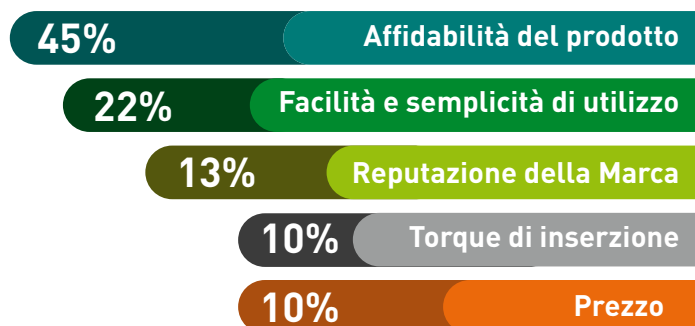


2 Quanti impianti mediamente mette in un mese?

Da 5 a 10	193	84%
Da 10 a 40	28	12%
Oltre 40	9	4%

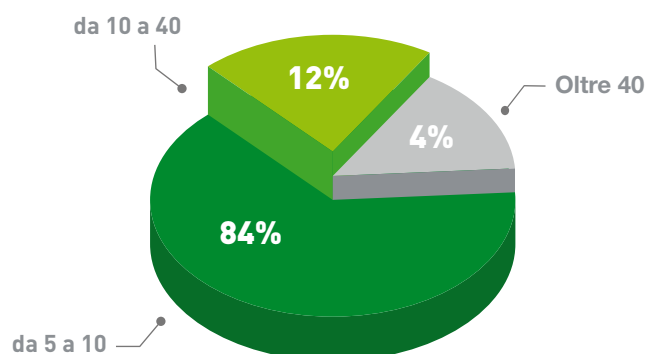

3 Utilizza la macchina solo nel suo studio?

La utilizzo io solo nel mio studio	104	45%
La utilizzano dei collaboratori solo nel mio studio	48	21%
La utilizzo sia nel mio studio sia attraverso consulenze nello studio di colleghi	78	34%

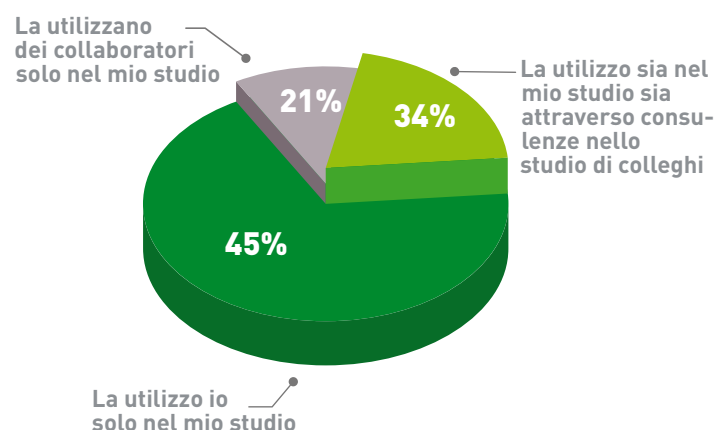

➤ MOTORI DA ENDODONZIA

Denominazione del prodotto	CHIROPRO L 	ENDO E CLASS	ENDO25	ENDOMATE DT
Produttore	Bien-Air Dental SA	Marathon	Aseptico Inc. Usa	NSK
Dettagli	Motore con luce LED multifunzionale con impostazioni pre-programmate ma modificabili	Autodiagnosi	Digitale elettronico completamente programmabile per automatizzare le procedure operative	Micromotore adatto a tutti gli strumenti NiTi. Con manipolo ricaricabile. Accurato controllo della velocità e del torque
Tipologia motore	Induzione, no lubrificazione	Induzione, autoclavabile	Micromotore brushless	•
Numero di giri (min e max – rpm)	100-40.000 con 1:1	20-17.500	50-5.000	100-650
Torque max regolabile (Ncm)	55	9,9	23-750	6,5
Feedback	Si	Si	•	•
Tipo di Tastiera e di display	Semplificata che consente la gestione dei programmi	Digitale/display LCD	I parametri di velocità, torque e rapporto di riduzione, tutti visualizzabili sul display grafico, possono essere impostati e memorizzati in base alle esigenze cliniche	Ampio display LCD
Da utilizzare con manipolo/contrangolo separabile	Si	Si	Si	Si
Pedale di attivazione motore	Si	Si	Si	No
Autoreverse	Si	Si	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso nel set	Si	Si	No	Si
Peso totale apparato (Kg)	3,900	910 gr.	1,6	548 gr. ca.
Dimensioni unità di controllo (mm)	309x220x123 (con asta 506)	175x125x90	•	92x147,5x124
Paese di produzione	Svizzera	Korea	USA	Giappone
Garanzia	12 mesi (18 mesi sul motore)	2 anni	•	12 mesi
Prezzo di listino*	Euro 4.952,00	Euro 1.000,00	Non fornito	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> MOTORI DA ENDODONZIA

Denominazione del prodotto	ENDOMATE TC2	ENDOS.A 	ENTRAN	MINIENDOS.B 
Produttore	NSK	Mariotti&C	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	Mariotti&C
Dettagli	Micromotore cordless dotato di 5 pulsanti di funzione, schermo LCD e avvisatore acustico. 5 diversi programmi	Motore endodontico con programmi strum. canalari, controllo separato di velocità e torque, reverse e autoreverse	Contrangolo ergonomico+manipolo con auto forward+auto reverse+5 livelli torque	Motore endodontico leggero e pratico, controllo separato di velocità e torque, reverse e autoreverse
Tipologia motore	•	Motore brush autoclavabile	Cordless	Motore brush autoclavabile
Numero di giri (min e max – rpm)	100-500	80-900 con 16:1	300	80-800 con 16:1
Torque max regolabile (Ncm)	4	130 mNm	0,5-4	130 mNm
Feedback	•	Si	Si	Si
Tipo di Tastiera e di display	Display LCD sul corpo del manipolo	Display LCD e tastiera membrana	Pannello di comando con pulsante avviamento e led indicazione torque selezionato	Display LCD e tastiera con pulsanti meccanici
Da utilizzare con manipolo/contrangolo separabile	Si	Si	Si	Si
Pedale di attivazione motore	No	Si	No	Si
Autoreverse	Si	Si	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso nel set	Si	Si/No	Si	Si/No
Peso totale apparato (Kg)	100 gr. ca.	3,5	0,120	1,5
Dimensioni unità di controllo (mm)	27x30x147	190x210x90	170,7	200x140x100
Paese di produzione	Giappone	Italia	Austria	Italia
Garanzia	12 mesi	2 anni	2 anni	2 anni
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 800,00	Euro 1.090,00	Euro 595,00

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MOTORI DA ENDODONZIA

Denominazione prodotto	TF ADAPTIVE	TRI AUTO MINI	WAVE ONE MOTOR	X-SMART	X-SMART PLUS
Produttore	Sybronendo	Morita	Dentsply Maillefer	Dentsply Maillefer	Dentsply Maillefer
Dettagli	Si basa su un brevetto di un algoritmo intelligente, progettato per lavorare con gli strumenti in NiTi Twisted Files	Manipolo Endodontico MINI Cordless interfacciabile con Root zx rilevatore apicale mini	C.lo 6:1 con testina miniature regolabile in 6 posizioni, programmi preimpostati e liberi, batteria ricaricabile	Con c.lo 16:1 ed interruttore ON/OFF, il micromotore pesa solo 92 gr compreso il cordone; 9 programmi personalizzabili e batteria ricaricabile	C.lo 6:1 con testina miniature regolabile in 6 posizioni, programmi preimpostati e liberi, batteria ricaricabile
Tipologia motore	Motore endodontico con 5 programmi preimpostati, M4 e uno completamente personalizzabile	Micromotore cordless	Motore a movimento continuo e reciprocante	Motore a movimento continuo	Motore a movimento continuo e reciprocante
Numero di giri (min e max – rpm)	Da 0 a 3.000 a seconda del programma	50-1.000	250-1.000	120-800	250-1.200
Torque max regolabile (Ncm)	Max 900 g-cm regolabile	Fino a 4	0,2-4 regolabile	0,6-5,2	0,6-4 regolabile
Feedback	•	•	Si	Si	Si
Tipo di Tastiera e di display	Display digitale LCD. Tasti che gestiscono RPM, torque, programma, reverse manuale	Display LCD multifunzione	Tastiera pratica ed ampio display di facile lettura	Pannello di comando configurato facilmente igienizzabile ed ampio display LCD	Navigazione “click & go” e tasto di comando per ogni funzione; ampio display di immediata lettura
Da utilizzare con manipolo/contrangolo separabile	Si	•	Si	Si	Si
Pedale di attivazione motore	Si	Si	Si	No	No
Autoreverse	Si	Si	Si	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso nel set	Si	Si	Si	Si	Si
Peso totale apparato (Kg)	0,9	100 gr.	1,1	1,5	1
Dimensioni unità di controllo (mm)	173x160x130	28x27x195	206x90x85	98x152x139	107x196x107
Paese di produzione	Usa	Giappone	Italia	Giappone	Giappone
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni	3 anni
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 1.318,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito

> MOTORI DA IMPLANTOLOGIA

Denominazione del prodotto	CHIROPRO L 	EASYBONE 4	ELCOMED SA-310	ICHIROPRO 
Produttore	Bien-Air Dental SA	Silfradent srl	W&H	Bien-Air Dental SA
Dettagli	Motore con luce LED multifunzionale con impostazioni pre-programmate ma modificabili	DI 400 (senza luce) DI 500 (con luce)	•	Utilizza tecnologia Apple e registra tutte le fasi operative rilasciando una scheda paziente
Tipologia motore	Induzione, no lubrificazione	Brushless, autoclavabile	Motore innovativo per chirurgia maxillo-facciale e implantologia	Induzione, no lubrificazione
Numero di giri (min e max – rpm)	100-40.000 con 1:1	200-40.000	300-50.000	100-40.000 con 1:1
Torque max regolabile (Ncm)	55	0-69 rid. 20:1	80	70,5
Feedback	Si	Si	Si	Si
Tipo di Tastiera e di display	Semplificata che consente la gestione dei programmi	Tastiera a membrana, display a due righe con 16 caratteri/9 mm	Tasti funzione e display a cristalli liquidi retroilluminato	Viene inserito nella console un iPad e tutto è gestito dalla App dedicata dallo schermo
Programmi	Implantologia, endodonzia, chirurgia	4 liberi	6 con ogni funzione liberamente impostabile	Implantologia, chirurgia di vari produttori di impianti
Riduzioni possibili per manipoli/contrangoli	128:1/64:1/30:1/27:1/20:1/16:1/10:1/1:1/1:2/1:5	33 riduzioni impostabili, x5 fino a 1.024	Ampia gamma di manipoli e contrangoli utilizzabili	256:1/128:1/64:1/30:1/27:1/20:1/16:1/10:1/1:1/1:2/1:5
Portata pompa peristaltica	30-150 ml/min	0-50 ml	90 ml/min	30-150 ml/min
Funzioni del pedale	Controllo pompa, reverse, avanzamento-ritorno steps, avvio	Due pedali=SB 300 P: On/Off e DI500PV pedale multifunzione	Regolazione velocità, selezione programma, reverse, abilitazione/esclusione pompa	Controllo pompa, reverse, avanzamento-ritorno steps, avvio
Velocità variabile a pedale	0-40.000 con 1:1	On-Off	300-50.000 rpm	0-40.000 con 1:1
Luce led	Si	Si	Si	Si
Pompa peristaltica indipendente dal motore	Si	Si	Si	Si
Inversione di rotazione	Si	Si	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso	Si	No	No	Si
Peso totale apparato (Kg)	3,9	4,1	•	3,9
Dimensioni unità di controllo (mm)	309x220x123 (con asta 506)	250x256x125	109x256x305	242x241x102 (con asta 485)
Garanzia	12 mesi (18 mesi sul motore)	12 mesi	12 mesi	12 mesi (18 mesi sul motore)
Paese di produzione	Svizzera	Italia	Austria	Svizzera
Prezzo di listino*	Euro 4.952,00	Euro 1.690,00-2.070,00	Euro 4.780,00	Euro 5.680,00

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MOTORI DA IMPLANTOLOGIA

Denominazione del prodotto	IMPLANTMED SI-923	KI-20	MINIUNIKO.C 	MINIUNIKO.CL 
Produttore	W&H Dentalwerk Burmoos	Marathon	Mariotti&C	Mariotti&C
Dettagli	Utilizzo: implantologia, chirurgia orale, stomatologica, facciale	Autodiagnosi	Motore brushless per implantologia	Motore brushless per implantologia con luce LED ad alta luminosità. Ampio display e tastiera touch
Tipologia motore	Motore a induzione 5,5 Ncm sterilizzabile termodisinfezzabile	Induzione, autoclavabile	Micromotore brushless autoclavabile	Micromotore brushless autoclavabile
Numero di giri (min e max – rpm)	300-40.000	20-40.000	200-30.000 con 1:1	200-30.000 con 1:1
Torque max regolabile (Ncm)	70	5-70	Limitato a 60	Limitato a 60
Feedback	Si	Si	Si	Si
Tipo di Tastiera e di display	Tasti funzione e grande display a cristalli liquidi retroilluminato	Display digitale LCD	Display LCD e tastiera meccanica con encoder	Display LCD e tastiera capacitiva touch
Programmi	5 di cui 1 con funzione integrata di maschiatura	9	8, richiamabili anche da pedaliera	10, richiamabili anche da pedaliera
Riduzioni possibili per manipoli/contrangoli	Contrangolo chirurgico 20:1; manipolo chirurgico 1:1	1:1/1:2/20:1/32:1	1:1/ 10:1/ 16:1/ 20:1/ 27:1/ 32:1/ 40:1/ 50:1/ 64:1/ 100:1/ 128:1/ 256:1/ 1024:1	1:1/ 10:1/ 16:1/ 20:1/ 27:1/ 32:1/ 40:1/ 50:1/ 64:1/ 100:1/ 128:1/ 256:1/ 1024:1
Portata pompa peristaltica	90 ml/min	off/50-75-90 ml/min	90 ml/min	90 ml/min
Funzioni del pedale	Regolazione velocità, selezione programma, reverse, abilitazione/esclusione pompa	4	Attiva e regola il motore (a velocità variabile), reverse, irrigazione, richiamo dei 10 programmi memorizzabili	Attiva e regola il motore (a velocità variabile), reverse, irrigazione, richiamo dei 10 programmi memorizzabili
Velocità variabile a pedale	300-40.000 rpm	Si	Si	Si
Luce led	Si	Si	No	Si
Pompa peristaltica indipendente dal motore	No	No	Si	Si
Inversione di rotazione	Si	Si	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso	No	Si	No	No
Peso totale apparato (Kg)	2,7	2,87	5	5
Dimensioni unità di controllo (mm)	100x235x240	240x225x97	245x245x100	245x245x100
Garanzia	12 mesi	2 anni	2 anni	2 anni
Paese di produzione	Austria	Korea	Italia	Italia
Prezzo di listino*	Euro 3.045,00	Non fornito	Euro 2.380,00	Euro 2.560,00

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> MOTORI DA IMPLANTOLOGIA

Denominazione prodotto	 MINIUNIKO.F	OSSEO SYSTEM	OSSEOCARE™ PRO	SURGIC PRO LED
Produttore	Mariotti&C	XO Care's A/S	Bien-Air	NSK
Dettagli	Motore brushless per implantologia	Per chirurgia ed implantologia. Adatto per interventi di massima precisione e sicurezza	•	Consolle chirurgica con luce LED, sistema integrato di doppia calibrazione del manipolo (elettronico/meccanico), 64 diversi programmi (8x8)
Tipologia motore	Micromotore brushless autoclavabile	Micromotore brushless per implantologia	Micromotore elettrico a corrente continua senza spazzole	Ultraleggero (Ø23,5x103,3 mm), ad induzione, corpo in titanio
Numero di giri (min e max – rpm)	200-30.000 con 1:1	300-40.000	100-40.000	200-40.000
Torque max regolabile (Ncm)	Limitato a 60	65	70	80
Feedback	Si	•	Si	•
Tipo di Tastiera e di display	Display LCD e tastiera meccanica con encoder	LCD senza tastiera, chiavi di accesso personalizzabili con step di procedura	Controllo tramite app per iPad®	Display LCD retro illuminante sull'unità di controllo
Programmi	8, richiamabili anche da pedaliera	•	Inserzione impianti, chirurgia guidata, personalizzabili	8 personalizzabili, ciascuno con 8 funzioni
Riduzioni possibili per manipoli/contrangoli	1:1/ 10:1/ 16:1/ 20:1/ 27:1/ 32:1/ 40:1/ 50:1/ 64:1/ 100:1/ 128:1/ 256:1/ 1024:1	20:1 e 1:1	20:1	1:1/20:1/1:2/1:3/1:5
Portata pompa peristaltica	90 ml/min	Standard 35 ml/min; regolabile da 20 a 65 ml/min	30-150 ml/min	75 ml/min
Funzioni del pedale	Attiva il motore	Funzionalità no touch completa tramite pedale	Reostato, reverse, irrigazione, switch programmi	Controllo velocità del micromotore, regolazione quantità soluzione irrigante, scelta programma, controllo della direzione di rotazione
Velocità variabile a pedale	No	Si	Si	Si, pedale reostato
Luce led	No	Si	Si	Si
Pompa peristaltica indipendente dal motore	Si	Si	No	No
Inversione di rotazione	Si	•	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso	No	No	Si	Si
Peso totale apparato (Kg)	4	7,3	3,85	•
Dimensioni unità di controllo (mm)	245x245x100	5,5	242x244x102	265x220x100
Garanzia	2 anni	•	2 anni	12 mesi
Paese di produzione	Italia	Danimarca	Svizzera	Giappone
Prezzo di listino*	Euro 1.900,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MOTORI DA IMPLANTOLOGIA

Denominazione prodotto	SURGIC PRO+	TRAUS SIP10 LED	UNIKO.PZ
Produttore	NSK	Saeshin LTD	Mariotti&C
Dettagli	Consolle chirurgica LED, sistema integrato di doppia calibrazione del manipolo (elettronico/meccanico), 64 diversi programmi (8x8), memorizzazione dati di intervento (100 min.) con chiave USB, manipolo smontabile in Titanio	Micromotore ad induzione a led. Potenza led 25.000 lux, funzione di autodiagnosi, 9 programmi memorizzabili, torque max di 80 ncm comprensivo di contrangolo fibrato	Unità doppia motore brushless con luce LED per implantologia e piezo chirurgico
Tipologia motore	Ultraleggero (Ø23,5x103,3 mm), ad induzione, corpo in titanio	Induzione	Micromotore brushless autoclavabile
Numero di giri (min e max – rpm)	200-40.000	20-40.000	200-30.000 con 1:1
Torque max regolabile (Ncm)	80	80	Limitato a 60
Feedback	•	Si	Si
Tipo di Tastiera e di display	Display LCD retro illuminante sull'unità di controllo	Display a membrana	Display LCD e tastiera capacitiva touch
Programmi	8 personalizzabili, ciascuno con 8 funzioni	9	10, richiamabili anche da pedaliera
Riduzioni possibili per manipoli/contrangoli	1:1/20:1/1:2/1:3/1:5	20:1/32:1/64:1/1:1/1:5	1:1/ 10:1/ 16:1/ 20:1/ 27:1/ 32:1/ 40:1/ 50:1/ 64:1/ 100:1/ 128:1/ 256:1/ 1024:1
Portata pompa peristaltica	75 ml/min	Max 75 ml/min	90 ml/min
Funzioni del pedale	Controllo velocità del micromotore, regolazione quantità soluzione irrigante, scelta programma, controllo della direzione di rotazione	Velocità, torque, pompa, inversione di marcia	Attiva e regola il motore (a velocità variabile), reverse, irrigazione, richiamo dei 10 programmi memorizzabili
Velocità variabile a pedale	Si, pedale reostato	Si	Si
Luce led	Si	Si	Si
Pompa peristaltica indipendente dal motore	No	Si	Si
Inversione di rotazione	Si	Si	Si
Manipolo/contrangolo incluso	Si	Si	No
Peso totale apparato (Kg)	•	4,5	6
Dimensioni unità di controllo (mm)	265x220x100	233x269x120	245x245x130
Garanzia	12 mesi	12 mesi	2 anni
Paese di produzione	Giappone	Korea	Italia
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 2.450,00	Euro 6.450,00

INFO OPERATORI

Aseptic INC. USA

(Dati forniti da Sweden& Martina - 049.9124300
www.sweden-martina.com)

Bien-Air Dental SA

02.58321251 - www.bienair.com
(Per OsseoCare™ Pro dati forniti da Nobel Biocare Italiana srl
www.nobelbiocare.com)

Dentsply Maillefer

www2.dentsplymaillefer.com
(Distributore ufficiale Simit Dental - 0376.267811
www.simidental.it)

Marathon

081.7442191 - 081.7413104
www.marathonitalia.com

Mariotti&C - 0543.474105

www.mariotti-italy.com

Morita - 02.87394532

www.jmoritaItalia.com

NSK (Dati forniti da

Dentalica - 02.895981

www.dentalica.com)

Saeshin LTD

(Dati forniti da VCG

Ventura 02.90782908

www.vcgventura.com)

Silfradent srl

0543.970684

www.silfradent.com

Sybronendo

www.sybronendo.com/eu

W&H Dentalwerk

Burmoos GmbH

035.6663911 - www.wh.com/it

XO Care's A/S

(Dati forniti da Sweden&

Martina - 049.9124300

www.sweden-martina.com)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Motore da implantologia Mariotti con luce led



Lo staff di progettazione Mariotti&C, in collaborazione con esperti implantologi, introduce il nuovo motore per chirurgia e implantologia con luce LED ad alta luminosità. Mantenendo le caratteristiche di semplicità di utilizzo e praticità, MiniUNIKO.CL offre le più alte performance per valori di torque, elevate sicurezza e precisione

operativa con qualunque sistema di impianti ed è compatibile con i diversi manipoli e contrangoli (con fibra ottica e non) presenti sul mercato. Il dispositivo è composto da: un'unità di controllo con ampio display e tastiera capacitiva "touch" per un uso immediato; un motore brushless di ultima generazione con luce LED

ad alta luminosità; la pedaliera multifunzione che può controllare il motore, il reverse, l'irrigazione e il richiamo dei 10 programmi memorizzabili. Presenti nel set anche l'asta inox per fisiologica, il supporto manipolo e due tubi di irrigazione. Il torque massimo è limitato a 60Ncm, la portata massima della pompa peristaltica d'irrigazione è 90 ml/min, le dimensioni dell'unità di controllo sono 245x245x100 mm. Garantita la lunga durata dell'intero apparato comprese le parti da sterilizzare, è autoclavabile il motore con cavo e connettore. Accessorio ideale è il contrangolo ottico Mariotti C32L, che include la fibra ottica per motori led, riduzione 32:1, irrigazione esterna e possibilità di irrigazione interna. Questo assicura la massima affidabilità e un torque elevato fin dai bassi giri.

Motore endodontico MiniEndos Mariotti, semplicità e affidabilità



Mariotti&C, grazie ai tanti anni di esperienza nella costruzione di motori per endodonzia, presenta il sistema MiniEndos semplice e pratico, progettato per strumenti canalari Ni-Ti. MiniEndos gestisce velocità e torque in maniera separata, grazie ad una unità di controllo intuitiva, flessibile


e con un ampio display. Con grande semplicità di utilizzo si può impostare il torque massimo a 4 step diversi con possibilità di autoreverse al valore desiderato. MiniEndos con poche ed essenziali funzioni garantisce all'odontoiatra affidabilità e prestazioni precise. Inoltre è possibile riporre e

trasportare facilmente l'apparecchio in una borsina, articolo NB a richiesta. Manipolo ideale è il contrangolo E16 con riduzione 16:1, studiato nelle dimensioni per la massima praticità in endodonzia.

PER INFORMAZIONI
MARIOTTI&C srl Progettazione e costruzione micromotori
Via Seganti 73
47121 Forlì
Tel. 0543.474105
Fax 0543.781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com



Massima affidabilità
Facilità d'uso
Grandi performance

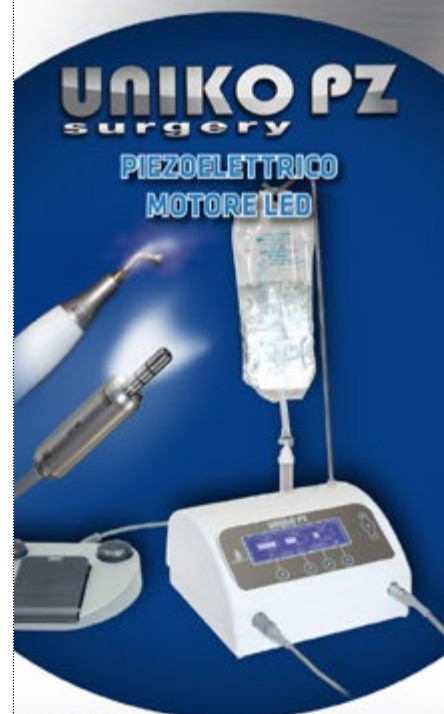

CE
0476

MARIOTTI & C. srl
Via Seganti 73
47121 Forlì - Italy
Tel +39 0543 474105
Fax +39 0543 781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com



Motori per endodonzia MX-i Bien Air

I motori MX e MX-i da riunito e utilizzati sul Chiropro L garantiscono ottime performance in endodonzia in quanto, essendo a induzione, offrono una eccellente stabilità e controllo durante le fasi di lavoro. Il loro range operativo è di un minimo di 100 rpm fino ad un massimo di 40.000 rpm. Questa caratteristica li

rende adatti alle pratiche endodontiche con l'utilizzo di un manipolo 1:1 in quanto non necessita di ridurre ulteriormente il numero di giri del motore.

L'opportunità appena descritta Vi consente di contenere i costi, in quanto il contrangolo 1:1 è tra quelli maggiormente utilizzati da Voi, quindi già presente tra

gli strumenti del Vostro studio.

Il Chiropro L contiene un programma specifico per endodonzia, oltre ai programmi per l'implantologia, in grado di gestire tutte le fasi operative che tale branca della odontoiatria richiede in assoluta tranquillità, precisione e sicurezza.

iCHIROPRO, l'implantologia con motori Bien Air

iChiropro, comando con applicazione dedicata per iPad, è lo strumento che soddisfa le esigenze dei giovani professionisti che si stanno affacciando al mondo dell'implantologia per la semplicità d'uso abbinata alla multifunzionalità che lo contraddistingue e per essere nello stesso tempo un validissimo supporto operativo per i professionisti più esperti.

iChiropro contiene i protocolli operativi delle maggiori case di impianti, è dota-

to di un micromotore MX-i brushless ad induzione che garantisce potenza, stabilità, illuminazione LED anche ad un basso numero di giri. Il micromotore è auto ventilato, autoclavabile, il suo peso è estremamente contenuto e non necessita di lubrificazione.

Il manipolo in dotazione è il CA 20:1 L che presenta una irrigazione esterna in ingresso ma interna in uscita, in modo da eliminare il canale di uscita della fisiologica vicino alla testi-

na che molto spesso è causa di problemi e fastidi durante le fasi operative. Questo CA è il più piccolo manipolo dedicato per implantologia.

iCHIROPRO, il motore che per le sue caratteristiche si pone ad un livello di eccellenza indiscutibile.



Via E. Vaina, 3
20122 Milano
Tel. 02.58321251
Fax 02.58321253
www.bienair.com

PER INFORMAZIONI
Bien Air Italia srl

Physioline components SEMPLICITÀ e PRECISIONE

SINUS LIFTING SYSTEM

Rialzo seno mascellare



EXECUTIVE BONE DRILL

Recupero osso autologo



KEY POINT SYSTEM
Sistema di fissaggio
per membrane.



PHYSIOLINE[®]
BIOMEDICAL TECHNOLOGY