


Riuniti da 10.000 a 20.000 Euro

Sondaggio su **290** responder


Nella scelta di un riunito quali aspetti reputa più importanti?

Il prezzo	35	12 %
La marca	87	30 %
L'equipaggiamento	168	58 %

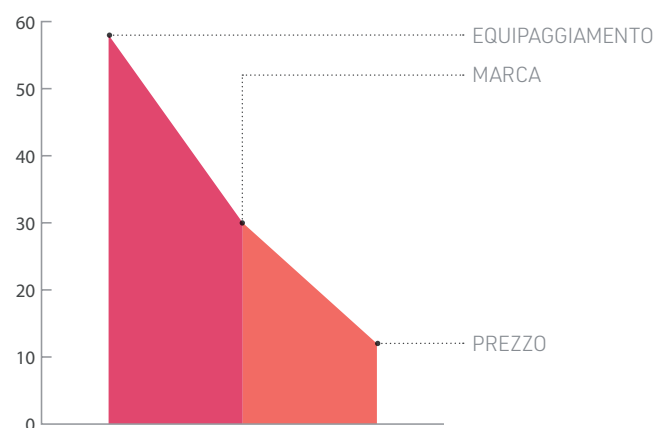


Tra le modalità di pagamento quale preferisce?

Leasing/noleggio	151	52 %
Pagamento alla consegna con sconto	41	14 %
Pagamento dilazionato direttamente all'azienda	98	34 %

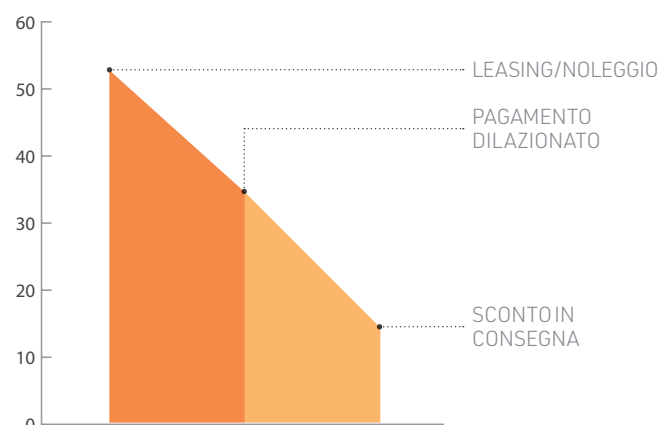

Tra i vari optional di cui può essere dotato un riunito, quale per Lei è il più importante?

Telecamera e monitor	58	20 %
Micromotore ed ablatore	174	60 %
Lampada operatoria a led	49	17 %
Altro	9	3 %

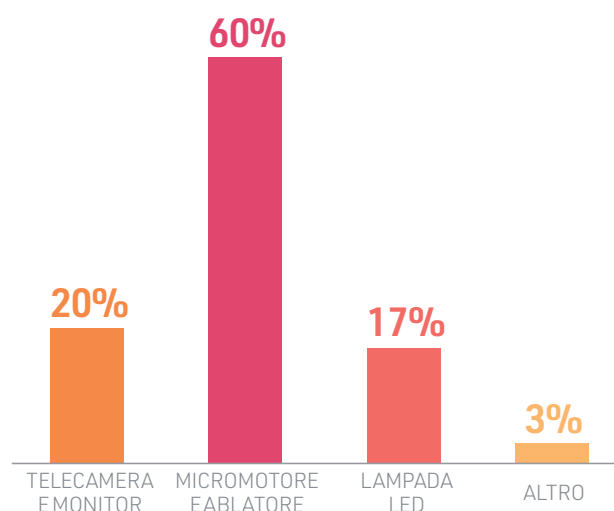

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

RIUNITI 10.000-20.000 Euro	Estetica E50 Life	Handy Surgery	Kiss
Produttore	KaVo Dental	Tecnomed Italia	Linea Diretta
Integrazione modulare	✔	✔	✔
Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati	Si opzionale	✘	✔
Lampada polimerizzante	Presente su tavoletta assistente opzionale	Presente su tavoletta medico	Assente
Campo luminosità (lux), ampiezza fascio e assorbimento (W) lampada	1.200 mWcm², 420-480 nm	1.500-3.500 mW/cm²	Intensità 15.000-24.500 lux, 2 assi di movimentazione, assorbimento lampadina 12V 50W Low pressure
Fonte luminosa della lampada	Led	Led	Led
Collegamenti USB in faretra	✔ opzionale	✘	✘
Collegamenti LAN alla rete dello studio	✔ opzionale	✘	✘
Gruppo idrico	A terra	A terra	Sospeso
Computer medicale integrato	✘	✘	✘
N° strumenti presenti nella dotazione e dimensioni tavoletta medico	5+1 opzionale	6	Ablatore, siringa aria/acqua, micromotore elettrico, 2 cordoni f.o./42x34 cm, faretra
Micromotore elettrico (Nm) e giri/min	2,8 /100-40.000	Torque 3,5 Ncm/2.000-40.000	⊗
Display su tavoletta medico	✔	✔	✘
N° strumenti tavoletta assistente	2+2 (opzionali)	2	3
Comandi tavoletta assistente	Riemp. bicchiere, risciacquo bacinella, mov. poltrona e memorie, disinfezione circuiti idrici, hydroclean, acc. Lampada, funzione Composave con lampada KaVo540 LED, timer	Bicchiere, bacinella, aspirazione	Movimentazione poltrona, reset e last position, bicchiere, bacinella, lampada
Tipo di cordoni	Standard liscio	Safety handpiece	Standard
Comandi gestuali	✔ per lampada KaVo 540 LED	✘	✔
Poltrona con movimenti compensati	✔	✔	✔
Pedaliera multifunzione per controllo strumenti, poltrona e lampada	✔	✔	✘
Funzionalità per mancini/ambidestri	✔	✔	✔
Sistema antiriflusso spray	✔	✔	✔
Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti	✔ sistema continuo ed intensivo	✔ bottiglia+wek light Metasys	✔ tramite una tanica sotto il gruppo idrico
Indipendenza circuiti cannule aspirazione	✔ opzionale	✘	⊗
Alimentazione spray indipendente	✔	✔	✔
N° di memorizzazioni per utente	60	⊗	3
Sistemi di sicurezza presenti	Antischiacciamento poltrona, schienale, bacinella, assistente, pedaliera e pedana	⊗	Push di sicurezza
Teleassistenza remota via ethernet	✘	✘	✘
Lavaggio cannule di aspirazione	✔ opzionale	✔ sistema Sanivac	✘
Prezzo di listino*	⊗	⊗	Euro 10.990,00
Info azienda	Tel. 010.83321 www.kavokerr.com	Tel. 0721.955125 www.tecnomeditalia.it www.handysurgery.com	Tel. 035.731895 www.lineadirettamed.com

Kiss HI-Tech	Nice Glass	Nice Touch	Opportunity Top
Linea Diretta	Miglionico srl	Miglionico srl	Copega
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✘
Assente, optional	Presente su tavoletta medico e assistente	Presente su tavoletta medico e assistente	Assente
Intensità 15.000-24.500 lux, 2 assi di movimentazione, assorbimento lampadina 12V 50W Low pressure	3.000-50.000, spot 190x90, assorb max 26 VA	3.000-50.000, spot 190x90, assorb max 26 VA	⊗
Led	Led	Led	Led
✔	✘	✘	✘
✔	✔	✔	✘
Sospeso	Sospeso	Sospeso	Sospeso
✔	✔	✔	✘
Ablatore, siringa aria/acqua, micromotore elettrico, 2 cordoni f.o./42x34 cm, faretra	Fino a 6	Fino a 6	4
⊗	A induzione torque fisso con regolazione 500-40.000	A induzione torque fisso con regolazione 500-40.000	Bien Air 60-40.000
✔	✔	✔	✔
3	Fino a 4. 2 cannule per l'aspirazione + 2 strumenti a scelta. Alloggiamenti removibili e autoclavabili	Fino a 4. 2 cannule per l'aspirazione + 2 strumenti a scelta. Alloggiamenti removibili e autoclavabili	Cannule per l'aspirazione
Movimentazione poltrona, reset e last position, bicchiere, bacinella, lampada	Mov. poltrona, on/off lampada operatore, acqua calda/fredda bicchiere, lav. bacinella, pos. di emergenza, richiamo memorie poltrona	Mov. poltrona, on/off lampada operatore, acqua calda/fredda bicchiere, lav. bacinella, pos. di emergenza, richiamo memorie poltrona	Riemp. bicchiere, risc. bacinella, 4 memorie, comandi poltrona
Standard	Standard	Standard	Standard
✔	✘	✘	✘
✔	✔	✔	✔
✘	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✘
✔	✔	✔	✔
✔ tramite una tanica sotto il gruppo idrico	✔ MDS: Sistema di disinfezione dei circuiti automatico e in continuo. Miscela l'acqua di rete con liquido disinfettante	✔ MDS: Sistema di disinfezione dei circuiti automatico e in continuo. Miscela l'acqua di rete con liquido disinfettante	✔ flushing e ultra spray
⊗	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
3	7	7	4
Push di sicurezza	Antischiacciamento: base poltrona, schienale, base bacinella, braccio assistente	Antischiacciamento: base poltrona, schienale, base bacinella, braccio assistente	Antischiacciamento schienale
✘	✘	✘	✘
✘	✔ manuale	✔ manuale	✔ flushing box
Euro 13.990,00	⊗	⊗	Euro 19.747,00
Tel. 035.731895 www.lineadirettamed.com	Tel. 080.759552 www.miglionico.net	Tel. 080.759552 www.miglionico.net	Tel. 02.3282190 www.copega.it

RIUNITI 10.000-20.000 Euro			
Produttore	Tecnomed Italia	Planmeca Oy	Galbiati 1935
Integrazione modulare	✓	✓	✓
Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati	✓	✓	✓
Lampada polimerizzante	Presente su tavoletta medico e assistente	Presente su tavoletta medico e assistente	Presente su tavoletta assistente
Campo luminosità (lux), ampiezza fascio e assorbimento (W) lampada	1.500-3.500 mW/cm²	Ampiezza fascio 440-465 nm, assorbimento 24 VAC ± 10% - 50/60 Hz, intensità luminosa 1500 ± 20% Mw/cm²	420/480 nm/120 mW/cm², assorbimento ≤ 8 W
Fonte luminosa della lampada	Led	Led, Nuova Lampada Led: Planmeca Solanna 50.000 lux	Led
Collegamenti USB in faretra	✗	✓	✗
Collegamenti LAN alla rete dello studio	✗	✓	✓
Gruppo idrico	Sospeso	A terra	A terra
Computer medicale integrato	✓	✗	✗
N° strumenti presenti nella dotazione e dimensioni tavoletta medico	5, 52x52 cm	Fino a 5/194x296 mm oppure 296x380 mm	5
Micromotore elettrico (Nm) e giri/min	Torque 3,5 Ncm/2.000-40.000	0,1-3 Ncm/40.000 - 100-40000 – max torque 3,5 Ncm	0-40.000, regolato automaticamente 35
Display su tavoletta medico	✓	✓	✓
N° strumenti tavoletta assistente	4	3	4
Comandi tavoletta assistente	Manuali, bicchiere, bacinella, trandelburg, lampada, boiler	Movimenti completi poltrona, on/off luce operativa, pulsante acqua bacinella, pulsante acqua bicchiere	Acc/spegn. luce scialitica, selezione acqua di rete, selezione carico acqua alternativo, pulsante di emergenza, memoria e movimentazione poltrona, riemp. bicchiere, lav. bacinella
Tipo di cordoni	Safety handpiece	Safety handpiece	Standard
Comandi gestuali	✓	✓	✗
Poltrona con movimenti compensati	✓	✓	✗
Pedaliera multifunzione per controllo strumenti, poltrona e lampada	✓ joystick per movimentazioni	✓	✓
Funzionalità per mancini/ambidestri	✓	✓	✓
Sistema antiriflusso spray	✓	✓	✓
Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti	✓ bottiglia+wek Metasys	✓ WCS – Waterline Clinic System, Metasys WEK oppure WCM	✓ automatico
Indipendenza circuiti cannule aspirazione	✗	✓	✓
Alimentazione spray indipendente	✓	✓	✓
N° di memorizzazioni per utente	6	9	4
Sistemi di sicurezza presenti	Poltrona, lato assistente, gruppo idrico	Antischiacciamento su schienale, seduta, piedi; lato assistente schiacciamento della strumentazione, sistema di sicurezza dello sportello del gruppo idrico, protezione dal sistema anti schiacciamento attivo nella faretra	Schienale e poltrona
Teleassistenza remota via ethernet	✗	✓	✗
Lavaggio cannule di aspirazione	✓ sistema automatico Sanivac	✓ sistema WMS – Water Management System integrato a riunito	✗
Prezzo di listino*	✗	✗	✗
Info azienda	Tel. 0721.955125 www.tecnomeditalia.it www.handysurgery.com	Dental Network srl a socio unico Agenzia esclusiva per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.com/it	Tel. 02.39305598 www.galbiati.com

Legenda: 🔍 approfondimento 🎯 focus prodotto 🚫 non fornito ✓ SI ✗ NO

Syncrus G8	
Gnatus	
✓	
✓	
Assente	
✗	
Led	
✓	
✓	
Sospeso	
✗	
5	
Micromotore a led, induzione, torque fisso	
✓	
4	
Riempimento bicchiere, lav. bacinella, comandi poltrona	
Safety handpiece	
✗	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓ manuale	
✓	
✓	
4	
Antischiacciamento poltrona	
✗	
✗	
✗	
Tel. 331.4503434 www.gnatus.it	

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Consulta sul nostro sito la sezione online dedicata ai confronti.

Visita infodent.it/confronti

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Su www.ilmiodentista.it 39.000 studi odontoiatrici. Il tuo c'è?

www.ilmiodentista.it - info@ilmiodentista.it