


Riuniti fino a 10.000 Euro

Sondaggio su **280** responder


Nella scelta di un riunito quali aspetti reputa più importanti?

Il prezzo	50	18 %
La marca	84	30 %
L'equipaggiamento	146	52 %

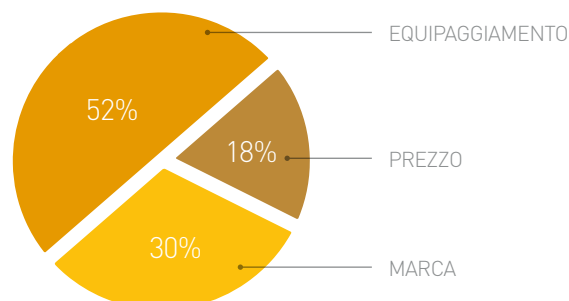


Tra le modalità di pagamento qual è quella che preferisce?

Leasing/Noleggio	132	47 %
Pagamento alla consegna con sconto	70	25 %
Pagamento dilazionato direttamente all'azienda	78	28 %

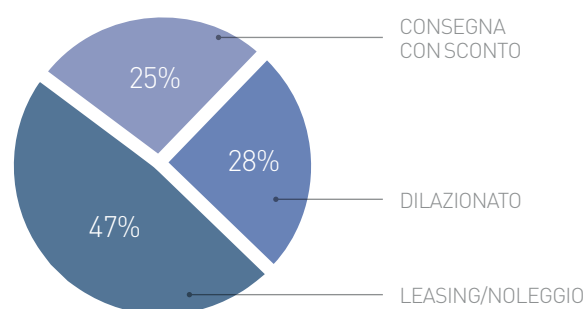

Tra i vari optional di cui può essere dotato un riunito, quale per Lei è il più importante?

Telecamera e monitor	56	20 %
Micromotore ed ablatore	146	52 %
Lampada operatoria a LED	56	20 %
Altro	22	8 %

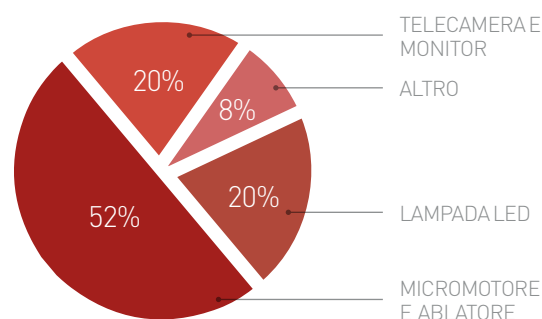

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> RIUNITI FINO A 10.000 EURO						

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto

	Tipo di cordini	Standard	Standard	Safety handpiece	Standard	Standard	Standard
	Comandi gestuali	Si	No	Si lampada	Si	Si	No
	Poltroina con movimenti compensati	Si	No	Si	Si	Si	Si
	Pedaliera multifunzione per controllo strumenti, poltrona e lampada	Si	No	Si	Si	Si	Si
	Funzionalità per mancini/ambidestri	No	Si	Si optional	Si	No	No
	Sistema antiriflusso spray	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti	Si tramite 2 taniche sotto il gruppo idrico	Si sistema di filtraggio 0,05 su tutto il circuito idraulico e sistema safety spray a mezzo bottiglia per la disinfezione del circuito idrico	Si su pro	Si tramite 2 taniche sotto il gruppo idrico	Si tramite 2 taniche sotto il gruppo idrico	No
	Indipendenza circuiti cannule aspirazione	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Sistema indipendente di alimentazione spray	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	N. di memorizzazioni per professionista consentite	3	4	2	3	3	0
	Sistemi di sicurezza presenti	No	Antischiaffamento su seduta poltrona, schienale poltrona e tavoletta assistente. Filtro HEPA su scarico aria turbine che garantisce una riduzione del livello di contaminazione, bacinella asportabile e autoclavabile, sistema safe air system	•	Si, opzionale su standard	No	3
	Teleassistenza da remoto via ethernet	No	No	Si optional	No	No	No
	Lavaggio cannule di aspirazione	No	No	Si optional	No	No	No
	Prezzo di listino*	Euro 4.590,00	Non fornito	Non fornito	Euro 6.450,00, euro 5.450,00 (standard)	Euro 5.990,00	Non fornito
	Info azienda	Tel 035.731895 www.lineadirettamed.com	Tel. 051.6258657 www.swident.it	www.sirona.it/ft/products/ riuniti/intego/	Tel. 035.731895 www.lineadirettamed.com	Tel 035.731895 www.lineadirettamed.com	Tel. 080.759552 www.migliorico.net

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> RIUNITI FINO A 10.000 EURO																			
Prodotto	OPPORTUNITY COMPACT	OPPORTUNITY LITE	OVER	PARTNER	PIAVE P30	PIAVE P75	SS ONE												
Produttore	Copega	Copega	Tecnomed Italia srl	Swident srl	Ascor Group	Ascor Group	Simple&Smart												
Integrazione modulare	Si	No	Si	No	Si	Si	Si												
Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati	•	Si	Si	Si	No	No	Si												
Lampada polimerizzante	Assente	Presente su tavoletta medico e assistente optional	Presente su tavoletta medico e assistente	Presente su tavoletta medico e assistente	Assente	Assente	Presente su tavoletta assistente												
Campo luminosità lampada fotopolimerizzante (lux – min-max), ampiezza fascio e assorbimento (W) lampada	30.000, 3 assi di movimentazione	1.250 mw/cm² con puntale da 7,5 fino a 3000 mw/cm² con puntale 5,5. Spettro effettivo da 430 a 470 nm	350 Mw/cm²	1.250 mw/cm² con puntale da 7,5 fino a 3.000 mw/cm² con puntale 5,5. Spettro effettivo da 430 a 470 nm	•	•	•												
Fonte luminosa della lampada	Led	Alogena, led opzionale	Led, alogena	Led			Led												
Collegamenti LAN del riunito alla rete dello studio	No	Si	No	Si	No	No	Si												
Gruppo idrico	Sospeso	Sospeso	Sospeso	Sospeso	Sospeso	Sospeso	Sospeso												
Computer medicale integrato	No	Si	Si	Si	No	No	•												
N° strumenti presenti nella dotazione e dimensioni tavoletta	Ablatore, siringa aria/acqua, 3 cordoni f.o., sgabello. Dimensioni faretra: 42x45 cm	Fino a 5	5	Tavoletta operatore fino a 5 strumenti	4 strumenti, 455x355x105 mm	4 strumenti - 455x355x105 mm	5 strumenti, una siringa completa, 1 ablatore con 5 punte e 3 cordoni a fibra ottica												
Micromotore elettrico e giri/min	Non compreso	A torque fisso/60-40.000	Induzione torque 20-100%/ 2.000-40.000	Micromotore elettrico a torque fisso/60-40.000	Bien-Air MC2 Isolite 300/60-40.000 con luce	Bien-Air MC2 Isolite 300, 60-40.000 con luce	Made by TKD Italy, brushless, LED/ 40.000												
Display su tavoletta medico	No	No	Si	No	No	No	Si												
N° strumenti tavoletta assistente presenti nella dotazione	3	Fino a tre strumenti (es. 2 tubi aspirazione, lampada foto o siringa)	4	Fino a quattro strumenti (es. 2 tubi aspirazione, lampada foto e siringa)	2	2	3												
Comandi presenti sulla tavoletta assistente	Movimentazione poltrona, reset e last position, bicchiere, bacinella, lampada	Riempimento bicchiere, riempimento bacinella	Movimenti poltrona-bicchiere, bacinella boiler, lampada	Riempimento bicchiere, riempimento bacinella, movimenti poltrona, richiamo memoria poltrona e accensione lampada operatoria	Riempimento bicchiere, lavaggio bacinella	Riempimento bicchiere, lavaggio bacinella	Bicchieri, bacinella, reset, risciacquo, movimentazione poltrona, boiler acqua calda, comando negatoscopio												

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

		Standard	Standard	Safety handpiece	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Tipo di cordini		No	No	Si	No	No	No	No	No	No	Standard
Comandi gestuali		No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No
Poltroina con movimenti compensati		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pedaliera multifunzione per controllo strumenti, poltrona e lampada		Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzionalità per mancini/ambidestri		No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si
Sistema antiriflusso spray		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti		Flushing	Flushing	Si wek light Metasys	Si sistema di filtraggio 0,05 su tutto il circuito idraulico e sistema safety spray a mezzo bottiglia per la disinfezione del circuito idrico	No	No	No	No	No	Si doppio
Indipendenza circuiti cannule aspirazione		No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema indipendente di alimentazione spray		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
N. di memorizzazioni per professionista consentite		4 più ritorno ultima posizione	4 più ritorno ultima posizione	4+trandelenburg	4	3	3	3	3	3	3
Sistemi di sicurezza presenti		Antischiacciamento base e schienale; autoesclusione degli strumenti	Antischiacciamento base e schienale; autoesclusione degli strumenti	6 antischiacciamento e fermo poltrona in fase di lavoro	Antischiacciamento su seduta poltrona, schienale poltrona e tavoletta assistente. Filtro HEPA su scarico aria turbine che garantisce una riduzione del livello di contaminazione, bacchetta asportabile e autoclavabile, sistema safe air system	Antischiacciamento base e schienale poltrona, blocco poltrona con strumenti attivi	Antischiacciamento base e schienale poltrona, blocco poltrona con strumenti attivi	Antischiacciamento base e schienale poltrona, blocco poltrona con strumenti attivi	Antischiacciamento elettrico		
Teleassistenza da remoto via ethernet		No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
Lavaggio cannule di aspirazione		Si inserito nel sistema di igienizzazione Flushing	Si inserito nel sistema di igienizzazione Flushing	Si sistema Danivak Technomed	No	No	No	No	No	No	Si
Prezzo di listino*		Euro 9.750,00	Euro 9.950,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 8.900,00
Info azienda		Tel. 02.3282190 www.copega.it	Tel. 02.3282190 www.copega.it	Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it	Tel. 051.6258657 www.swident.it	Tel. 02.89772030 www.rinutipiave.it	Tel. 02.89772030 www.rinutipiave.it	Tel. 02.89772030 www.rinutipiave.it	Tel. 035.0172056 www.simplesmart.it		

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

iTalo.2017

LINEA DIRETTA da sempre sviluppa i propri riuniti grazie alla collaborazione con gli studi dentistici degli stessi soci fondatori



il gruppo idrico è un elemento particolarmente interessante, in quanto permette all'operatore, soprattutto durante le sedute chirurgiche, di lavorare agevolmente anche sul lato sinistro del paziente. Infine, il nuovo modello è equipaggiato con un doppio sistema di filtri per l'aspirazione e motori di movimentazione potenziati. A Rimini, durante la fiera Expodental Meeting, LINEA DIRETTA ha presentato il nuovo modello di iTalo e anche il nuovo sito internet aziendale, che diventerà una vera e propria piattaforma di comunicazione ed offrirà informazioni innovative e sempre aggiornate.

iTalo standard
Euro 5.450,00 + iva

iTalo multimedia
Euro 6.450,00 + iva

Dal continuo e costante lavoro **nel 2017 LINEA DIRETTA è orgogliosa di proporre un nuovo modello: iTalo.2017.**

Abbiamo infatti apportato importanti migliorie rispetto alla precedente versione come, ad esempio, il radicale cambiamento dello schienale, che oggi risulta molto più avvolgente per il paziente e più ergonomico per l'operatore: la nuova forma e la struttura più

sottile, oltre a dare al riunito un design ancor più accattivante, lascia maggiore spazio alle gambe del dentista, ciò a vantaggio di un movimento più libero e comodo. Anche il poggiatesta è stato perfezionato: una maggiore concavità consente al paziente un appoggio migliore e più confortevole. Il braccio che apre la postazione assistente è stato allungato ed abbiamo aggiunto un ulteriore snodo per facilitare l'uti-

lizzo degli aspiratori ai dottori che lavorano senza assistente. Un importante intervento di sviluppo è stato apportato al gruppo idrico: il telaio che lo supporta è stato completamente rivisto al fine di migliorare la stabilità della poltrona e, soprattutto, **oggi possiamo spostare, su richiesta, il gruppo idrico in modo da renderlo utilizzabile anche agli operatori mancini.**

Inoltre la possibilità di ruotare

Ringraziamo tutti i nostri clienti che ci hanno dato consigli e spunti per arrivare oggi alla nuova linea iTalo 2017.

➤ **PER INFORMAZIONI**
LINEA DIRETTA
Leffe (BG)
Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com



**Disponibile da oggi anche
il nuovissimo sistema di riprese**



Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci

LABOMED LTS

L'unico a fornire dotazione di serie completa

Via Livia Drusilla 12, Roma T. 06.768472 F. 06.76984002 www.lts-srl.com - info@lts-srl.com