


SMARTGUIDE

LA PIATTAFORMA DIGITALE DI NUOVA GENERAZIONE

FACILE UTILIZZO E COSTO CONTENUTO

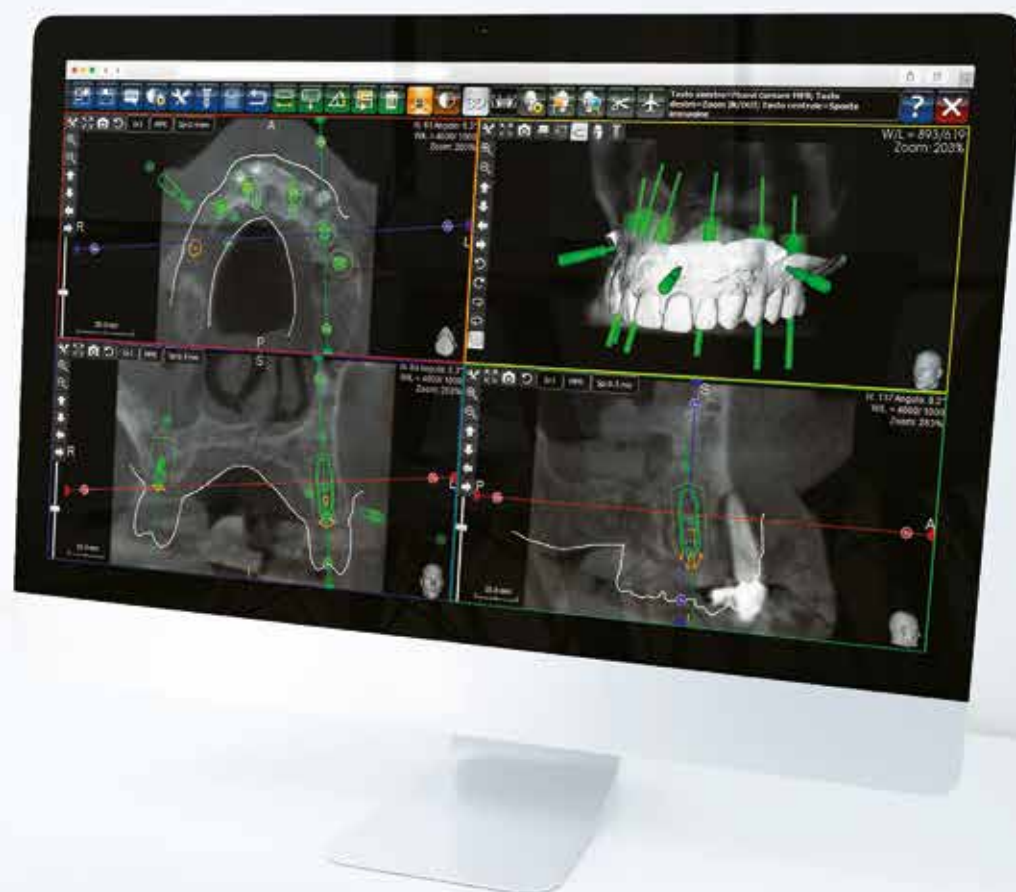

Attraverso il **software SmartGuide®** di iRES®, con pochi e semplici passaggi, puoi realizzare un piano di trattamento personalizzato.


Facile utilizzo, sistematica all'avanguardia, **costo contenuto**, processo fluido in tempi brevi, **chirurgia veloce** e atraumatica.

LASER CHIRURGICI

Sondaggio su **350** responder


In quale campo utilizza più di frequente il laser?

Trattamenti parodontali	140	40%
Frenulectomia	70	20%
Cure, traumi dentali, devitalizzazioni	11	3%
Terapie analgiche	11	3%
Altro	118	34%

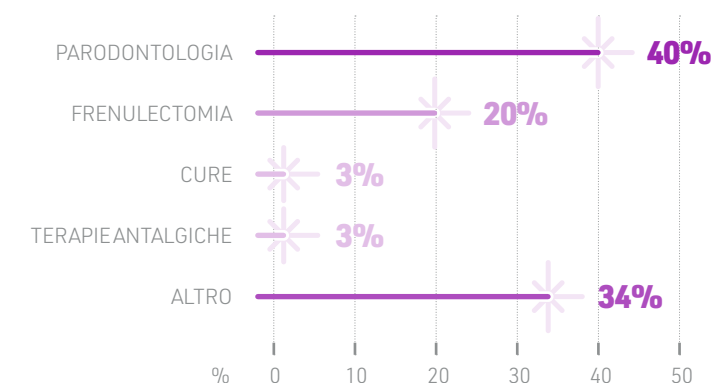


Quali sono i criteri di scelta da Lei adottati per una valutazione corretta del rapporto costi benefici?

Garantire uno standard di qualità elevato	220	63%
Soddisfare le richieste e le aspettative dei pazienti	80	23%
La tecnologia	18	5%
Il prezzo	32	9%

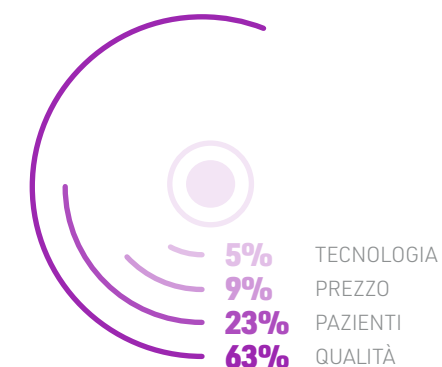

Quale tipologia di laser usa nel suo studio?

Diodi	231	66%
Laser Combinati	60	17%
Nd-Yag	0	0%
CO ₂	21	6%
Erbio	38	11%

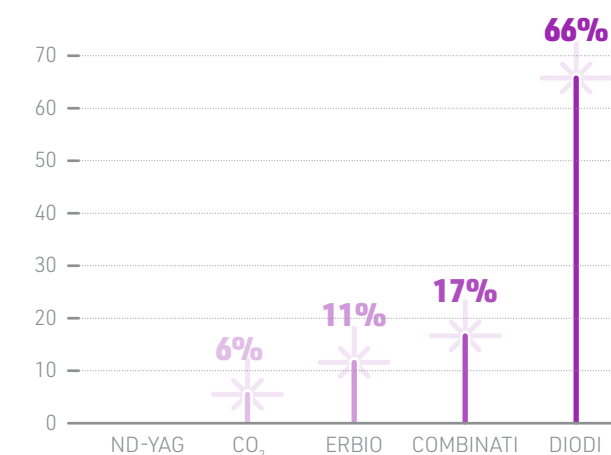

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

LASER CHIRURGICI	DG-8 Platinum	Doctor Smile Pluser	Doctor Smile Wiser
Produttore	Swiss & Wegman srl	Lambda spa	Lambda spa
Fornitore dati tecnici	•	•	•
Classe medica e classe laser	II B/4	II B/4	II B/4
Sorgente laser	⊗	Erbium-YAG	Diodo
Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)	25x22x8,5/4	28x55x89/35	16x18x21/1,85
Lunghezza d'onda (nm)	808+5	2.940	980
Potenza massima (W)	8	12	16
Tipologia fibra ottica e tipologia connettore fibra	Fibra ottica in silice con connettore proprietario	Guida d'onda e connettore SMA 905	Silica HCS e Connettore SMA 905
Modo di emissione impulso	Treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno
Frequenza (Hz) e durata dell'impulso (µs)	2.000	5-100/75-1.000	25.000/20
Lunghezza (cm) e diametri fibra disponibili (µm)	2,75/200-300-400	150/300-400-600-800	180/200-300-400
Raggio pilota (nm/mw)	Rosso 650	650/1	650/1
Tipologia Delivery System	Fibra ottica tradizionale	Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili
Tipologia software	Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato, modificabile e assistito
Tipo di alimentazione	A rete	A rete	A condensatori
Corrente assorbita (A)	1,5	5,2	8,33
Connessione a internet	✗	✓	✗
Visualizzazione protocolli on-board	✓	✓	✓
Accessori disponibili	Fibra da 300 µm completa di manipolo, manipolo terapeutico e ad ampie aree, 2 paia di occhiali protettivi, spella-fibra, taglia-fibra, asta reggifibra, pedale di comando, contatto interlock, cavo di alimentazione, protocolli e manuale utente	3 manipoli odontoiatrici, 2 manipoli dermatologici	Manipolo onda piana, manipolo dermatologico, kit LWS
Altre caratteristiche	Dotato di 60 protocolli pre-impostati per odontoiatria, estetica e traumatologia, accessori opzionali fibra da 200 µm, 400 µm, pedale e 3° paio di occhiali protettivi	2 tipologie d'onda, derma ready, piattaforma android, touch screen 10,1"	Laser assisted protocol, ricaricabile in soli 60 sec, enciclopedia clinica on-line
Prezzo di listino*	Euro 9.800,00	Euro 49.990,00	Euro 9.990,00
Info azienda	Tel. 049.8961111 www.swiss-wegman.com	Tel. 0444.349165 www.doctor-smile.com	Tel. 0444.349165 www.doctor-smile.com www.wiserlaser.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⊗ non fornito ✓ SI ✗ NO

Egg Laser	Epic X Total Package	FOXIII	Handy Pro
DMT Dental Medical Technologies	Biolase	A.R.C. Laser GmbH	Dentalica spa
•	HSK	Sweden&Martina	•
IV	IV	II B/4	II B/4
Diodo	Diodo semiconduttore	Diodo	Diodo
33x27x15	16,5x14,5x11,2/1	14x16x17/1,2	25,7x5,4x13,7/1,3
980-808-645	940±10	810	980
4	10	8	10
Tips/fibra ottica 320-200 µm	Fibra ottica standard con connettore ad attacco rapido	Fibra di vetro di quarzo. Connettore A.R.C. Laser GmbH patented	Fibra ✗ break, SMA 905
Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo	Continua o pulsata
⊗	Fino a 20.000/0.01-20	0,02-5000/100-900	Variabile in base al tipo di programma in uso
250	200-300-400	260/200-300	200-300-400
645/3	625-670/1	532 green <1	⊗
Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili
Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato, modificabile e assistito
A rete	A rete, a batterie	A rete, a batterie	A rete
⊗	Massimo 5	1,5	1,5
✗	✗	✗	✓
✓	✓	✓	✓
Full optional	2 manipoli chirurgici, punte pre-attivate, occhiali di protezione, manipolo per sbiancamento, gel di sbiancamento, manipolo per terapia antalgica	Chiavetta usb, fibra 300-200 µm, manipolo per chirurgia, spellafibra, tagliafibra, occhiali protettivi, manipolo per sbiancamento/trattamento emundo, fibra per sbiancamento	Puntali dedicati per chirurgia, parodontologia, endodonzia, implantologia, terapia e sbiancamento. Disponibile anche manipolo Onda piana
Procedure e tutorial vidimati dal dipartimento odontoiatria Università Vita salute Milano	Pedale wireless, schermo touch screen	⊗	Possibilità di integrare in Cloud agli 8 programmi già presenti, ulteriori 8 programmi advanced
⊗	Euro 5.490,00 + iva 22%	Euro 7.740,00	⊗
Tel. 039.481123 www.dmt.biz	Tel. 833.246.583 www.biolase.com (Dati forniti da Henry Schein Krugg Tel. 02.45773422 www.henryschein.it)	www.arclaser.de (Dati forniti da Sweden&Martina Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com)	Tel. 800.707172 www.dentalica.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

LASER CHIRURGICI	LASEmaR900R	 Lightwalker AT-S	Lightwalker ST-E PRO
Produttore	Eufoton srl	Fotona d.d.	Fotona d.d.
Fornitore dati tecnici	•	Emmeci 4	Emmeci 4
Classe medica e classe laser	II B/4	II B/4	II B/4
Sorgente laser	Diodo	Er:YAG + Nd:YAG	Er:YAG
Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)	24x14x25/3,8	55x29x82/59	55x29x82/59
Lunghezza d'onda (nm)	915	2.940+1.064	2.940
Potenza massima (W)	10	20+15	12
Tipologia fibra ottica e tipologia connettore fibra	Fibra ottica monouso o riutilizzabile con connettore SMA905 per applicazioni medicali	Da 200-320-945 con connettore SMA per Nd:YAG	⊗
Modo di emissione impulso	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Ripetizione, treno
Frequenza (Hz) e durata dell'impulso (µs)	500/1-9000 regolabile	Erbio 2-120/ 50-1.000; neodimio 10-100/120-25	2-120/50-1.000
Lunghezza (cm) e diametri fibra disponibili (µm)	250/100-200-300-400-600-1.000	4-20 µm/300-400-500-600-800-1.000-1.300	40-200/300-400-500-600-800-1.000-1.300
Raggio pilota (nm/mw)	635/5	532/1	532/1
Tipologia Delivery System	Fibra ottica tradizionale	Fibra ottica tradizionale, braccio articolato	Braccio articolato
Tipologia software	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato e modificabile
Tipo di alimentazione	A rete	A rete	A rete
Corrente assorbita (A)	80 VA	10	10
Connessione a internet	✗	✗	✗
Visualizzazione protocolli on-board	✓	✓	✓
Accessori disponibili	Manipolo per chirurgia a contatto e non, per terapia del dolore, per sbiancamento dentale	Manipoli per medicina estetica e dermatologia	Manipoli per medicina estetica e dermatologia
Altre caratteristiche	Smart card per aggiornamento rapido software, fiber emission controller integrato con visualizzazione 3D	Tecnologia ASP (Adjustable Shape Pulse), braccio Articolato OPTOFLEX compressore aria/acqua, integrato Temperatura Spray regolabile, protocolli PIPS/SWEEPS e NIGHT-LASE, software per medicina estetica	Tecnologia ASP (Adjustable Shape Pulse), braccio articolato OPTOFLEX, compressore Aria/Acqua integrato, temperatura spray regolabile, protocolli Endo SWEEPS/PIPS, nightlase
Prezzo di listino*	Euro 8.900,00	⊗	⊗
Info azienda	Tel. 040.9899082 www.eufoton.com	Distributore esclusivo per l'Italia EMMECI 4 Srl Tel. 0521.775337 www.emmeciquattro-laser.com	Distributore esclusivo per l'Italia EMMECI 4 Srl Tel. 0521.775337 www.emmeciquattro-laser.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Lumix Surgery Dental	Lumix Surgery Dual Dental	NanoYag	Ora-Laser D-light
Fisioline srl	Fisioline srl	DMT Dental Medical Technologies	Oralia Medical GmbH
•	•	•	Rident
II B/4	II B/4	IV	3R
Diodo	Diodo	Nd:YAG	Diodo Laser GaAlAs
21x30x16/3,5	21x30x16/3,5	17x28x28	Portatile 4,3 Kg
A scelta tra 810, 980, 1.064	A scelta tra 650, 810, 910, 980, 1.064	1.064	810
6-30	7-31	1,5	0,1
Fibra in quarzo con connettore SMA	Fibre in quarzo con connettore SMA	Tips/fibra ottica 320-200 µm	Diodo nel manipolo
Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno
1-100.000/TOn 0,5-100; TOff 1-300	1-100.000/TOn 0,5-100; TOff 1-300	25.000/3 nanosecondi	0-10.000
250/200-320-400-600	250/200-320-400-600	250	Puntali terapia 3,5+8+13 mm
650/5	650/5	615/3	635 <1
Fibra ottica tradizionale, Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica tradizionale, Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili
Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato e modificabile
A rete	A rete	A rete	A rete
0,7	0,7	⊗	0,5
✗	✗	✓	✗
✓	✓	✓	✓
Manipolo per fibra ottica chirurgica, Fibre 200 µm, 320 µm, pedale di sicurezza, arresto di emergenza, confezione di tips 20 pz., stripper regolabile, tagliafibre, 3 occhiali laser	Manipolo per Fibra ottica chirurgica, fibre 200 µm, 320 µm, manipolo terapeutico con connettore sma e con ottica intercambiabile, terminale in fibra e zoom, pedale di sicurezza arresto di emergenza, confezione di tips 20 pz., stripper regolabile, tagliafibre, 3 occhiali laser	Full optional	Bleaching, prodotti parodontio, cosmesi
Accessori opzionali: Manipolo terapeutico con connettore sma e con ottica intercambiabile, terminale in fibra, zoom e portante, distanziale conico e cilindrico, carrello modello "Dinamico", borsa porta apparecchio	Accessori opzionali: Terminale portante, distanziale conico e cilindrico, carrello modello "Dinamico", borsa porta apparecchio	Unica sorgente al mondo a 1.064 nm con impulsi in nanosecondi in odontoiatria, procedure e tutorial video delle applicazioni sulla macchina	Terapia Soft-laser, laserpuntura e ricerca del punto di agopuntura con manipolo, sbiancamento, trattamento del dolore, accelerazione della guarigione
A partire da euro 6.000,00	A partire da euro 8.500,00	⊗	Euro 4.300,00
Tel. 0172.470432/0172.470433 www.fisioline.com	Tel. 0172.470432/0172.470433 www.fisioline.com	Tel. 039.481123 www.dmt.biz	Tel. 045.8538159 www.oralia.com www.ridentinnovation.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

LASER CHIRURGICI	Ora-Laser D-lux	Pocket Laser	Primo Diodo Laser
Produttore	Oralia Medical GmbH	8853 spa	Medency srl
Fornitore dati tecnici	Rident	•	•
Classe medicale e classe laser	4	III B/4	II B/4
Sorgente laser	2 emettitori Diodi GaAlAs	Diodo	Diodo
Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)	28 Kg	10,1x16,4x4,5/0,7	20,5x13x5/3
Lunghezza d’onda (nm)	810	915	980-810
Potenza massima (W)	0,01 -20	6 nominali, 8 max	10-7
Tipologia fibra ottica e tipologia connettore fibra	Fibra con manipolo attivo + fibra 200-200E-400-600-applicatore T- applicatore A	Pigtail rivestita conn. SMA905 disponibili anche Tips	200 µm/Standard SMA
Modo di emissione impulso	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno
Frequenza (Hz) e durata dell’impulso (µs)	CW-20	20-15.000	25.000/20µs - 1 sec
Lunghezza (cm) e diametri fibra disponibili (µm)	Fibra con manipolo attivo + fibra 200-200E-400-600-applicatore T- applicatore A	200/200-300-400-600	200/200-300-400
Raggio pilota (nm/mw)	635 <1	635/3,5	650
Tipologia Delivery System	Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili
Tipologia software	Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato e modificabile
Tipo di alimentazione	A rete	A rete, a batterie	A rete, pacco batteria
Corrente assorbita (A)	7	3	8,33
Connessione a internet	✖	✖	✖
Visualizzazione protocolli on-board	✔	✔	✖
Accessori disponibili	Pedale, fotodinamica, bleaching, parodonto, cosmesi	Manipolo zafiro, manipolo multi con defoca- lizzati e prisma sbiancamento Tips	Arco da sbiancamento, Biotip, manipolo, terapia ATM , puntali intercambiabili per chirurgia, endodonzia e parodontologia
Altre caratteristiche	Chirurgia dei tessuti molli, sbiancamento, riduzione della carica batterica, coagulazio- ne, desensibilizzazione, terapia soft-laser, agopuntura, terapia fotodinamica	Preimpostati oltre 70 programmi clinicamen- te testati	Software Entry Level, Master mode (avan- zato)
Prezzo di listino*	Euro 14.900,00	⊗	⊗
Info azienda	Tel. 045.8538159 www.oralia.com www.ridentinnovation.com	Tel. 02.88531 www.88dent.com	Tel. 0444.371462 www.medency.com

Primo Lite Diodo Laser	Raffaello	RayStylus	Sirolaser Blue
Medency srl	DMT Dental Medical Technologies	Swiss & Wegman srl	Dentsply Sirona
•	•	Sweden&Martina	•
II B/4	IV	II B/4	II B/4 e 1
Diodo	Diodo	Diodo	Diodo
20,5x13x5/3	17x28x28	22x16x40/1	18,2x19,7x18,9/1,3
980	980-808-645	810	445-970-660
2,5	7	3	3 @445nm/2 @970nm/100 mW@660nm
200 µm/Standard SMA	Tips / fibra ottica 320-200 µm	Fibra ottica	Pigtail rivestita conn. SMA905 disponibili anche Tips
Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo	Ripetizione
25.000 Hz/20µs - 1 sec	⊗	1.000/500	1-10.000/10 µs-0,99 sec
200/200-300-400	250	200-300-400	200-320/320-200
650	645/3	⊗	660 ±5/max 1
Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili
Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato, modificabile e assistito	Pre-impostato, modificabile e assistito
A rete, pacco batteria	A rete	A batterie	A rete, a batterie
8,33	⊗	1,5	1,25-0,5
✖	✔	✖	✖
✖	✔	✔	✖
Arco da sbiancamento, Biotip, manipolo Terapia ATM , puntali ottici per endodonzia e parodontologia	Full optional	Base per ricarica e display, manipolo, alimentatore, cavo usb, 8 tips 300 micron, 2 tips 200 micron, 1 tip ampia area, 1 paio di occhiali protettivi certificati, 1 paio di occhialini “blind”	Manicotto manipolo con tastierino, EasyTip e Multi Tip vari diametri, occhiali di protezione dalle radiazioni laser anche per portatori di occhiali, gruppo batterie
Software Entry Level / Master mode (avanzato)	Procedure e tutorial video delle applicazioni sulla macchina	⊗	⊗
⊗	⊗	Euro 3.900,00	Euro 12.990,00
Tel. 0444.371462 www.medency.com	Tel. 039.481123 www.dmt.biz	www.swiss-wegman.com (Darti forniti da Sweden&Martina Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com)	www.dentsplysirona.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✖ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Francesco,
27 anni,
Assistente
Dentale,
il suo lavoro
gli piace.



L'ha trovato su
INFODENT.IT!

Infodent.it con oltre 20.000 inserzioni all'anno, offre alle Assistenti Dentali l'opportunità di cercare e trovare lavoro negli studi odontoiatrici in tutta Italia. Centinaia di annunci sempre nuovi per ottenere subito quello che stai cercando!

Inserisci subito,
gratuitamente,
i tuoi annunci !



LASER CHIRURGICI	Smart M PRO	Sol Laser
Produttore	Lasotronix	Denmat Holding
Fornitore dati tecnici	Emmeci 4	•
Classe medica e classe laser	II B/4	IV
Sorgente laser	Diodo, semiconduttore	Diodo
Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)	27x24,5x9/2,1	1 Kg
Lunghezza d'onda (nm)	980+635+405	808 (+5)
Potenza massima (W)	15-0,5	3 CW, 5 W P
Tipologia fibra ottica e tipologia connettore fibra	Fibra ottica SMA	Rimovibile, monouso, non riutilizzabile
Modo di emissione impulso	Singolo, ripetizione, treno	Ripetizione
Frequenza (Hz) e durata dell'impulso (µs)	10.000/50	Fissa 10/0,06 sec
Lunghezza (cm) e diametri fibra disponibili (µm)	250/200-300	400-300
Raggio pilota (nm/mw)	635/5	✖
Tipologia Delivery System	Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con puntali intercambiabili	Fibra ottica con puntali intercambiabili
Tipologia software	Pre-impostato e modificabile	Pre-impostato e modificabile
Tipo di alimentazione	A rete	A rete, a batterie
Corrente assorbita (A)	0,4	220 W
Connessione a internet	✖	✖
Visualizzazione protocolli on-board	✖	✖
Accessori disponibili	✖	Pedale wireless; occhiali protettivi, punte monouso
Altre caratteristiche	Sistema laser combinato e modulabile, USB Key per database, Kit biostimolazione e sbiancamento, Kit PAD (Photo Activated Disinfection), Kit medicina estetica	Laser portatile con batteria a lunga durata, manipolo ergonomico garantisce precisione, 4 programmi preimpostati
Prezzo di listino*	✖	Euro 3.490,00
Info azienda	Distributore esclusivo per l'Italia EMMECI 4 Srl Tel. 0521.775337 www.emmeciquattro-laser.com	Tel. 089.9331021 www.denmatitalia.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Sistema laser Fotona LightWalker AT-S

Il sistema laser Fotona LightWalker AT-S combina le due migliori lunghezze d'onda in odontoiatria, Er:YAG e Nd:YAG, per offrire la massima versatilità e un'ampissima gamma di applicazioni in:

- Odontoiatria Conservativa
- Endodonzia
- Parodontologia
- Chirurgia Orale
- Implantologia
- Trattamenti Estetici
- Trattamenti delle Roncopatie
- Biomodulazione.

Con LightWalker le procedure sono più rapide, semplici ed efficaci. I trattamenti laser sono per definizione minimamente invasivi e LightWalker porta questo concetto ad un livello superiore. La combinazione delle due migliori lunghezze d'onda in un unico sistema consente di sfruttare le

proprietà specifiche di ogni lunghezza d'onda nell'interazione con il tessuto. L'energia laser Nd:YAG è superiore per coagulazione e decontaminazione profonda, mentre l'Er:YAG è estremamente efficace nell'ablazione dei tessuti duri e molli. Combinate, queste due lunghezze d'onda possono incrementare notevolmente il risultato dei trattamenti laser, garantendo massima efficacia e sicurezza. Grazie alla tecnologia QSP e all'elevata potenza in uscita, il sistema LightWalker AT-S ha definito un nuovo standard nella velocità di taglio e ablazione. Ciò consente al Professionista di combinare rapidità, efficacia e precisione del taglio, con il massimo comfort per il paziente. LightWalker AT-S, inoltre, è dotato della tecnologia di terza generazione ASP (Adaptive Structured



Pulse), che combina l'ampissimo range di durate di im-

pulso della tecnologia Fotona VSP (Variable Square Pulse) con l'innovativa capacità della tecnologia ASP di adattare la struttura temporale degli impulsi laser alle dinamiche biofotoniche dell'interazione laser-tessuto. Con le sue caratteristiche esclusive e le tecnologie brevettate da Fotona, LightWalker AT-S rappresenta un vero e proprio sistema universale, sviluppato in modo specifico per assicurare la massima performance in campo odontoiatrico.

PER INFORMAZIONI
Emmeci 4 Srl
Via Traversante San Leonardo, 13/A
43122 Parma
Tel. 0521.775337
www.emmeciquattro.com

Riparazione Manipoli Dentali

I nostri rotori CareFree per turbine non necessitano lubrificazione!

Prova il Servizio in offerta a 95 Euro

Offerta valida per la riparazione di una turbina con sostituzione cuscinetti sistema CareFree Ritiro e consegna compresi, IVA esclusa. Garanzia sulle riparazioni di 6 mesi.

Vendita e Assistenza
MK-dent®
GERMANY

CMS 2000 Srl
Via Einaudi, 22
27015 Landriano (PV)
Tel.: 0382-954041 / Fax: 0382-953840
internet: www.cms2000.it
www.dentalwebstore.it

Numero Verde
800.031683

Chiamata a tutto il resto pensiamo NOI
Tutti i preventivi sono gratuiti

CMS 2000
tecnologia e innovazione